


A LAMELLÁS HUMERUS VELOŐRSZEG JELLEMZŐI



A proximális vég
4mm-es csavarokkal
reteszelt.

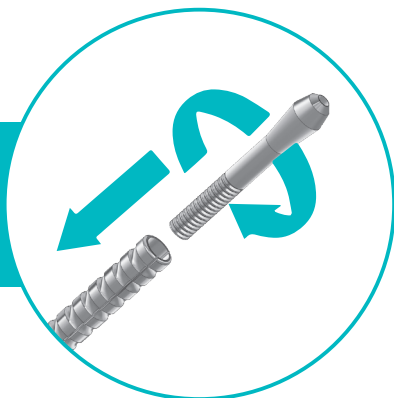

A canulált szeg distalis vége
három irányban
szétnyíló lamellákkal
rögzíthető a csontüregben



A reteszelt állapot a
prokszimális végben be-
vezetett hosszú csavarhúzó
segítségével bal irányba
forgatott reteszelő gombá-
val biztosítható.

Cégismertető

A BIONIKA Medline Kft. magyar családi vállalkozás, amit 1989-ben alapítottak magyar magánszemélyek. 35 éves tapasztalattal rendelkezünk az orvosi műszer és implantátum fejlesztésben, gyártásban és kereskedelemben.


A BIONIKA, mint kutató-fejlesztő, gyártó és forgalmazó egyaránt jelen van a fogászat, szájsebészet, traumatológia, ortopédia és rehabilitáció orvos-szakmai területein. Célkitűzésünknek és felfogásunknak megfelelően nagy jelentőséget tulajdonítunk a „BIONIKA” szónak, mely egy olyan tudományos gondolkodást jelöl a biológia, a technika és az elektronika határmezsgyéjén, amely ötvözi e három területet a kutató-fejlesztő munkánk során.

Klinikai és technológiai tapasztalatok: Sikereinkhez hozzájárul a klinikai és technológiai tapasztalatok folyamatos feldolgozása, ötvözése és hasznosítása a fejlesztésben, visszacsatolva egészen a gyártóbázisig. Itt születnek a vevői igényeknek legjobban megfelelő megoldások, konstrukciók, melyeket folyamatos fejlesztés alatt tartunk.

Fejlesztés: A BIONIKA tulajdonosai nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatos termék és technológiai fejlesztésekre. Termékeinket orvosok és mérnökök szoros együttműködésével fejlesztjük, mely által biztosítani tudjuk azok folyamatos világszínvonalú minőségét és gyakorlati használhatóságát egyaránt.

Minőség: A vevőink által elvárt minőséget a harmonizált Európai Uniói jogszabályok szerinti tervezés, gyártás és minőségirányítás garantálja. A BIONIKA Medline Kft. az EN ISO 9001 és az ISO 13485 minőségirányítási rendszer szerint működik. Termékeink CE jellel rendelkeznek.

Garancia: Az implantátum beültetést követően - a csontosodási folyamat kockázatát a BIONIKA magára vállalva - az ok-okozati összefüggésektől függetlenül - a vásárlást követő egy éven belül, cseregaranciát biztosítunk. Valamint termékeinkre hosszú távú, 10 éves garanciát adunk.

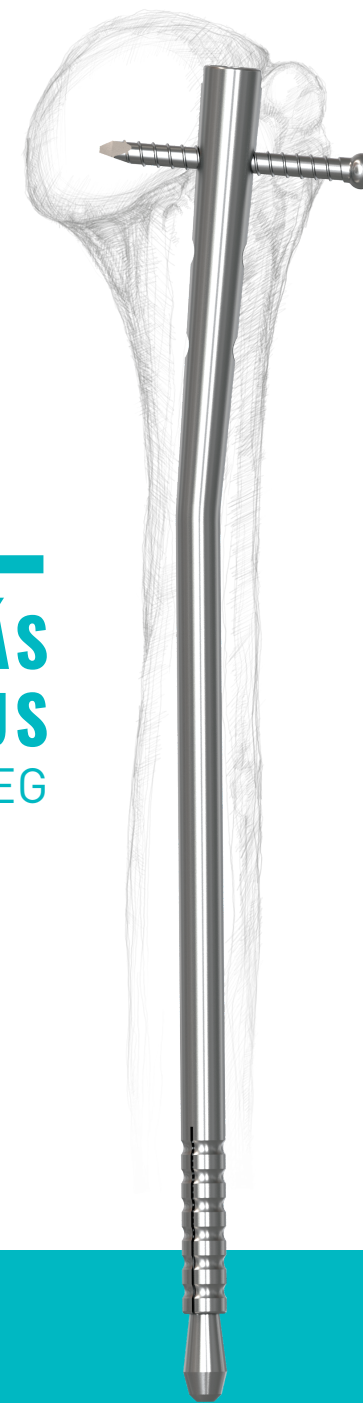

BHL LAMELLÁS HUMERUS VELOŐRSZEG

BIONIKA Medline Kft • 3516 Miskolc, Tégla u. 29.
www.bionika.hu • info@bionika.hu
mobil: +36 70 670-6875




A LAMELLÁS HUMERUS VELOŐRSZEG MÉRETVÁLASZTÉKA

Rendelési Kód	Megnevezés	Méret (mm)
103.001.700.180	Salgó Humerus velőúrszeg	D 7x180
103.001.700.200	Salgó Humerus velőúrszeg	D 7x200
103.001.700.220	Salgó Humerus velőúrszeg	D 7x220
103.001.700.240	Salgó Humerus velőúrszeg	D 7x240
103.001.700.260	Salgó Humerus velőúrszeg	D 7x260
103.001.700.280	Salgó Humerus velőúrszeg	D 7x280

103.001.800.140	Salgó Humerus velőúrszeg	D 8x140
103.001.800.160	Salgó Humerus velőúrszeg	D 8x160
103.001.800.180	Salgó Humerus velőúrszeg	D 8x180
103.001.800.200	Salgó Humerus velőúrszeg	D 8x200
103.001.800.220	Salgó Humerus velőúrszeg	D 8x220
103.001.800.240	Salgó Humerus velőúrszeg	D 8x240
103.001.800.260	Salgó Humerus velőúrszeg	D 8x260
103.001.800.280	Salgó Humerus velőúrszeg	D 8x280
103.001.800.300	Salgó Humerus velőúrszeg	D 8x300

103.001.900.180	Salgó Humerus velőúrszeg	D 9x180
103.001.900.200	Salgó Humerus velőúrszeg	D 9x200
103.001.900.220	Salgó Humerus velőúrszeg	D 9x220
103.001.900.240	Salgó Humerus velőúrszeg	D 9x240
103.001.900.260	Salgó Humerus velőúrszeg	D 9x260
103.001.900.280	Salgó Humerus velőúrszeg	D 9x280
103.001.900.300	Salgó Humerus velőúrszeg	D 9x300

A HUMERUS VELOŐRSZEG KIEGÉSZÍTŐK MÉRETVÁLASZTÉKA

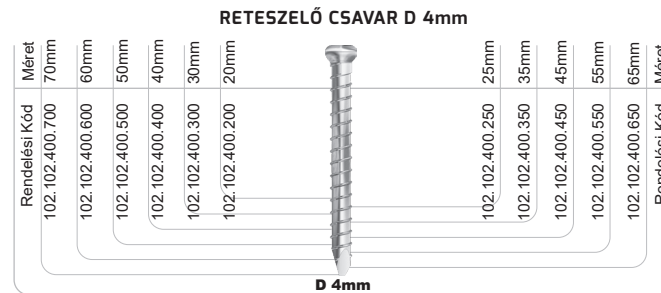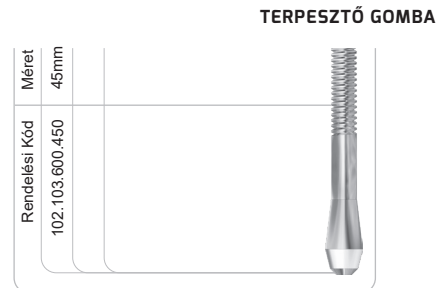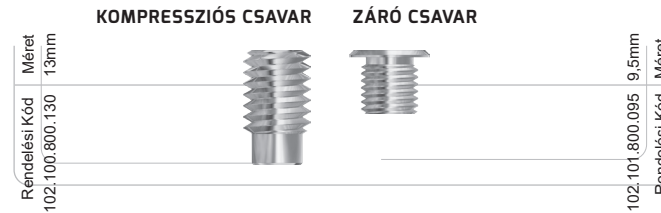

Alkalmazott alapanyagok

Velőúrszeg rendszereink alapanyaga ISO5832-1 Bioline 316L rozsdamentes acél vagy ISO5832-3 Titán Gr. 5, igény szerint.

A BIONIKA implantátumok gyártásánál alkalmazott Grade 5 minőségű titán implantológiai célra a legkedvezőbb tulajdonságokat mutatja. Megfelelő tisztasága miatt rendkívül jó a biokompatibilitása, mely mellett megfelelő szilárdsági tulajdonságokkal rendelkezik.

