



## A TÖMÖR HUMERUS VELŐŰRSZEG JELLEMZŐI


A proximális vég 4mm-es csavarokkal reteszelhető. Az axiális irányú kompresszió az ábrán látható módon biztosított. Ovális furat és kompressziós csavar alkalmazásával.

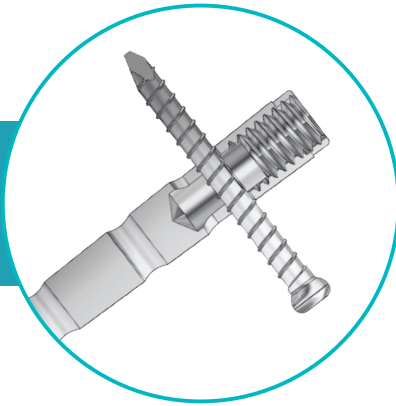

A tömör szeg, 7-8mm-es kör keresztmetszettel rendelkezik

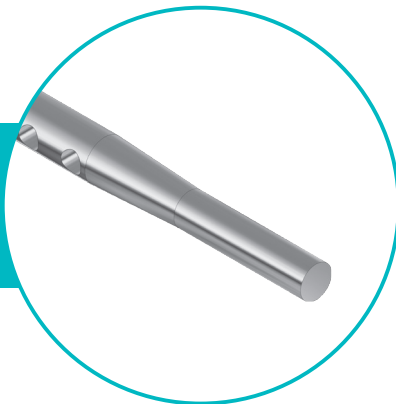

A distális vég reteszelését 4mm-es reteszcsavarokkal lehet megoldani, univerzális distális célzóval.

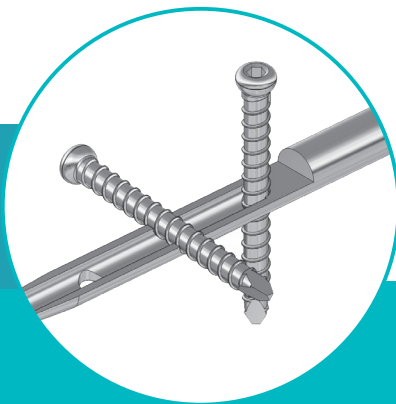

## Cégismertető

A BIONIKA Medline Kft. magyar családi vállalkozás, amit 1989-ben alapítottak magyar magánszemélyek. 35 éves tapasztalattal rendelkezünk az orvosi műszer és implantátum fejlesztésben, gyártásban és kereskedelemben.

A BIONIKA, mint kutató-fejlesztő, gyártó és forgalmazó egyaránt jelen van a fogászat, szájsebészet, traumatológia, ortopédia és rehabilitáció orvos-szakmai területein. Célkitűzésünknek és felfogásunknak megfelelően nagy jelentőséget tulajdonítunk a „BIONIKA” szónak, mely egy olyan tudományos gondolkodást jelöl a biológia, a technika és az elektronika határmezsgyéjén, amely ötvözi e három területet a kutató-fejlesztő munkánk során.

**Klinikai és technológiai tapasztalatok:** Sikereinkhez hozzájárul a klinikai és technológiai tapasztalatok folyamatos feldolgozása, ötvözése és hasznosítása a fejlesztésben, visszacsatolva egészen a gyártóbázisig. Itt születnek a vevői igényeknek legjobban megfelelő megoldások, konstrukciók, melyeket folyamatos fejlesztés alatt tartunk.

**Fejlesztés:** A BIONIKA tulajdonosai nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatos termék és technológiai fejlesztésekre. Termékeinket orvosok és mérnökök szoros együttműködésével fejlesztjük, mely által biztosítani tudjuk azok folyamatos világszínvonalú minőségét és gyakorlati használhatóságát egyaránt.

**Minőség:** A vevőink által elvárt minőséget a harmonizált Európai Uniói jogszabályok szerinti tervezés, gyártás és minőségirányítás garantálja. A BIONIKA Medline Kft. az EN ISO 9001 és az ISO 13485 minőségirányítási rendszer szerint működik. Termékeink CE jellel rendelkeznek.

**Garancia:** Az implantátum beültetést követően - a csontosodási folyamat kockázatát a BIONIKA magára vállalva - az ok-okozati összefüggésektől függetlenül- a vásárlást követő egy éven belül, cseregaranciát biztosítunk. Valamint termékeinkre hosszú távú, 10 éves garanciát adunk.

# BHN HUMERUS VELŐŰRSZEG




BIONIKA Medline Kft • 3516 Miskolc, Tégla u. 29.  
[www.bionika.hu](http://www.bionika.hu) • [info@bionika.hu](mailto:info@bionika.hu)  
 mobil: +36 70 670-6875

## A HUMERUS VELŐÚRSZEG MÉRETVÁLASZTÉKA


Rendelési Kód	Megnevezés	Méret (mm)
102.001.700.140	Tömör Humerus velőúrszeg	D 7x140
102.001.700.180	Tömör Humerus velőúrszeg	D 7x180
102.001.700.200	Tömör Humerus velőúrszeg	D 7x200
102.001.700.220	Tömör Humerus velőúrszeg	D 7x220
102.001.700.240	Tömör Humerus velőúrszeg	D 7x240
102.001.700.260	Tömör Humerus velőúrszeg	D 7x260
102.001.700.280	Tömör Humerus velőúrszeg	D 7x280

102.001.800.140	Tömör Humerus velőúrszeg	D 8x140
102.001.800.160	Tömör Humerus velőúrszeg	D 8x160
102.001.800.180	Tömör Humerus velőúrszeg	D 8x180
102.001.800.200	Tömör Humerus velőúrszeg	D 8x200
102.001.800.220	Tömör Humerus velőúrszeg	D 8x220
102.001.800.240	Tömör Humerus velőúrszeg	D 8x240
102.001.800.260	Tömör Humerus velőúrszeg	D 8x260
102.001.800.280	Tömör Humerus velőúrszeg	D 8x280
102.001.800.300	Tömör Humerus velőúrszeg	D 8x300

## A HUMERUS VELŐÚRSZEG KIEGÉSZÍTŐK MÉRETVÁLASZTÉKA

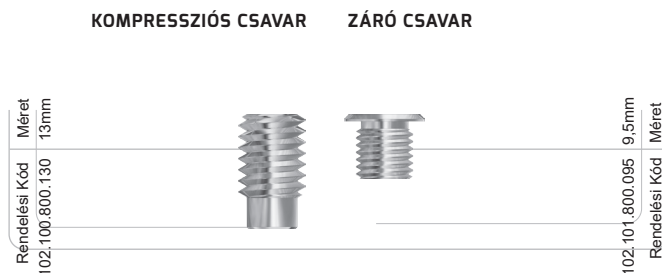

### RETESZELŐ CSAVAR D 4mm

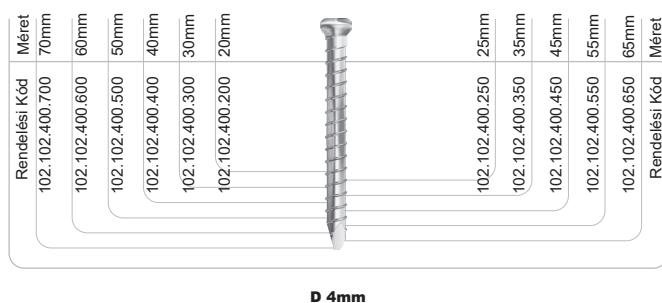

## Alkalmazott alapanyagok

Velőúrszeg rendszereink alapanyaga ISO5832-1 Bioline 316L rozsdamentes acél vagy ISO5832-3 Titán Gr. 5, igény szerint.

A BIONIKA implantátumok gyártásánál alkalmazott Grade 5 minőségű titán implantológiai célra a legkedvezőbb tulajdonságokat mutatja. Megfelelő tisztasága miatt rendkívül jó a biokompatibilitása, mely mellett megfelelő szilárdsági tulajdonságokkal rendelkezik.

