

BIONIKA



KÉPES Ajánlat

2023. 02.01-től 03.15-ig

2023
02
Február

-20%

Kedvezmény

-10%

Kedvezmény

-40%

Kedvezmény

-30%

Kedvezmény



BIONIKA Születésnap 2023.02.01

Ünnepeljen Velünk! Jöjjön el konferenciánkra!

Bíztató

Az orvostechnikai eszközöket gyártó cégeknek számos egészségügyi követelménynek és termékminőséget előíró szabványnak és jogszabálynak kell megfelelniük. A páciensek védelme érdekében 2017. április 5-én hatályba lépett az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályokat tartalmazó MDR (Medical Devices Regulations) rendelet, amely a korábbinál sokkal szigorúbb követelmények elé állítja az orvostechnikai eszközöket gyártó cégeket. Az MDR célja, hogy jelentős mértékben javítsa az orvostechnikai eszközök minőségét, biztonságosságát, megbízhatóságát és a piacfelügyeleti mechanizmusokat.



Ennek értelmében újra kell minősíteni az orvosi eszközöket, ezen belül a fogászati implantátumokat is. A gyártóknak az eddig elvártnál jóval több objektív adatot kell felmutatniuk és folyamatosan gyűjteniük ahhoz, hogy termékeiket tovább forgalmazhassák az Európai Unió országaiban. Az adatgyűjtés egyik módja a klinikai vizsgálat, amely az orvostechnikai eszközök biztonságosságának és teljesítmőképességének értékelését szolgálja. A BIONIKA a meglévő rendszerei közül a CORTILOG implantátum rendszert választotta ki a klinikai vizsgálat elvégzése céljából. A CORTILOG család tagjai között egyaránt megtalálhatók a mini, egyrészes, kétrészes és az ideiglenes implantátumok. Ezáltal a CORTILOG rendszer remekül reprezentálja a BIONIKA egységes gyártóbázisán előállított összes implantátum márkát, melyek megfelelnek az uniós orvostechnikai direktívának. Reményeink szerint a klinikai vizsgálatok eredményei is alátámasztják majd a CORTILOG implantátum rendszer biztonságosságát és megfelelőségét, az új jogszabályi előírásoknak és követelményeknek megfelelően, mint ahogy az a gyakorlatban is megtapasztalható volt az elmúlt 20 évben.



Kovács Zsolt
Operatív igazgató,
szakmai tanácsadó

Hajdú József
Tulajdonos, ügyvezető
igazgató



Bisnode Magyarország

A BIONIKA Medline Orvostechnikai Kft.
„Magyarország vállalkozásainak leg-
megbízhatóbb 0,63%-ába tartozik.”

ELINDULT A BIONIKA HŰSÉGPROGRAMJA!



**Gyűjtse a pontokat, váltsa őket forintra,
lépjen tagsági szinteket és élvezze a
hűségprogrammal járó egyedi előnyöket!**

CORTILOG MŰSZERKÉSZLET

A CORTILOG normál műszerkészlet tartalmazza a fogászati implantációhoz nélkülözhetetlen összes műszert. A nagy műszerkészlet a magyar ezüst sterilizáló tálcán és dobozon kívül, 14 különböző fajta extra minőségű műszert tartalmaz. A nagy méretválaszték és a széleskörű felhasználhatóság érdekében, összesen 37 műszer található benne.



***Árkedvezmény minden műszerkészletre**

TELJES RENDSZERBEN GONDOLKODUNK, ADUNK HOZZÁ IHLETET!

-40%

DISZTRIBÚTORI
ÁRON!

A BIONIKA CORTILOG IMPLANTÁTUM CSALÁD TAGJAI

~~32 000 Ft~~

19 200 Ft

~~32 000 Ft~~

19 200 Ft

~~32 000 Ft~~

19 200 Ft

~~32 000 Ft~~

19 200 Ft

~~41 600 Ft~~


24 960 Ft

~~25 400 Ft~~

15 240 Ft

~~16 000 Ft~~

9 600 Ft



CCL

Conical-Connection

Kúpos kapcsolata révén, mikromozgás mentes erőátvitelt eredményez és kifejezetten kedvező feltételeket biztosít a pontos mintavételhez. Az öt különböző átmérővel rendelkező CORTILOG CCL implantátum ötféle hosszban kapható, így minden csontszerkezet esetén egyaránt sikeresen alkalmazható.

PCL

Cső a csőben kapcsolat

Lapos platformmal és cső a csőben kapcsolattal rendelkezik, mely elfordulásgátlását a három cam biztosítja. Az implantátum bennmaradási esélyét lényegesen javítja, ha a corticalis szintre, illetve az alá kerül behelyezésre az implantátum felső pereme. Alacsony csontmagasság esetén csontpótlás nélkül is megoldást nyújthat.

ECL

Conical-Connection, aesthetic

A CORTILOG ECL implantátum fényes titánium része a lágyrészbe is könnyedén beültethető, ezáltal az alacsonyabb csontkínálattal rendelkező páciensek esetén is sikerrel alkalmazható. Ezzel az implantátummal leegyszerűsíthető a műtét folyamata, hiszen nincs szükség a mélyen ülő implantátumok feltárására.

LCL

Tissue Level Implantátum

Az LCL típusú implantátum kialakítása belülről megegyező a CCL típusúval. Azonban az implantátum homokszórás nélküli, fényes része a lágyrészbe is beültetésre kerülhet, ezáltal alacsonyabb csontkínálattal rendelkező pácienseknek is ideális megoldást biztosít. Alkalmazásával leegyszerűsíthető a műtét folyamata.

DCL

Egyrészes implantátum

A DCL rendszer három különböző átmérőjű ($\varnothing 3.8$ $\varnothing 3.3$ $\varnothing 4.3$) implantátumot foglal magába. Az implantátum test és fej rész egy geometriát alkot, így egyfázisú implantátumként használható. A DCL Multi-Unit fejű implantátumok csavarozott fogművekhez, míg a DCL egyenes fejű implantátumok ragasztott fogművekhez a legideálisabbak.

MCL


Alacsony csontkínálat esetén

Előfordult már Önnek, hogy páciense alacsony csontkínálattal érkezett a rendelőbe? A BIONIKA az ilyen esetekre fejlesztette ki a CORTILOG MCL implantátumot, ami a kis csontkínálattal rendelkező páciensek számára is lehetővé teszi, hogy visszakapják korábbi rágóképességüket. Az implantátum a műtét után akár már azonnal is terhelhető.

TCL

Ideiglenes implantátumok

Ideiglenes implantátum, amelynek alkalmazása azonnali megoldást nyújt az ideiglenes fogpótlások elkészítéséhez, miközben a végleges kétfázisú implantátum gyógyulási időszaka zajlik. A homokszórás nélküli felület késlelteti a teljes osseointegrációt, így könnyen és biztonságosan eltávolíthatók a végső fogpótlás behelyezése előtt.

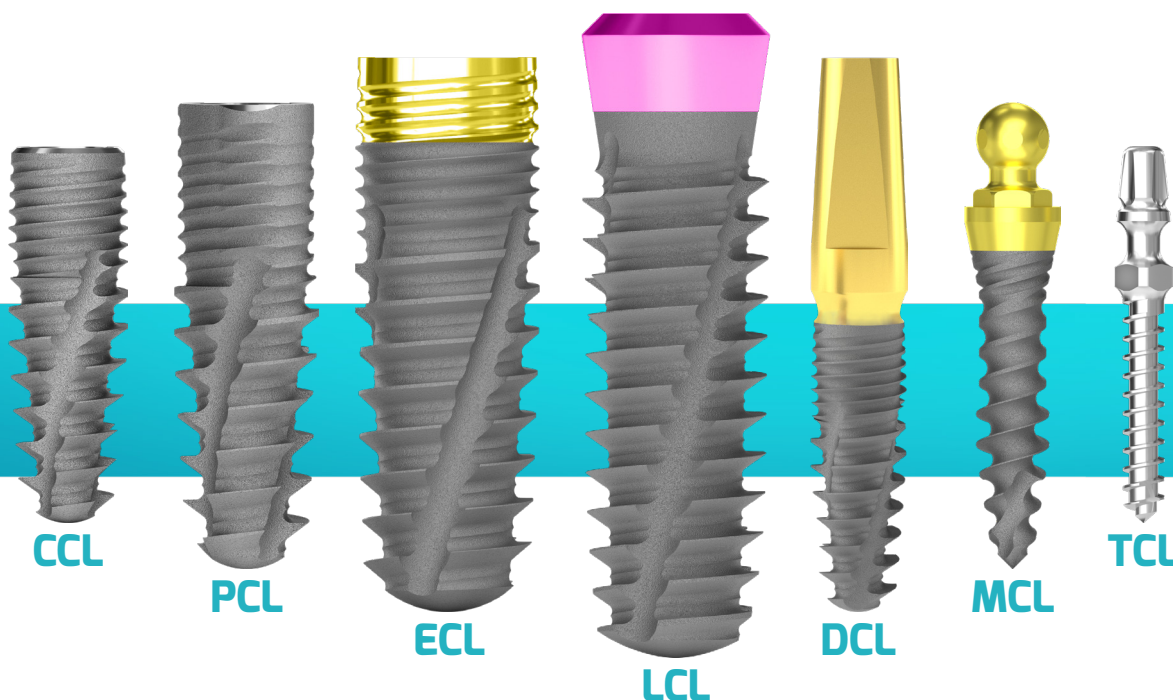


*Az árkedvezmény csak a CORTILOG Rendszer Implantátumaira vonatkozik.


TELJES RENDSZERBEN GONDOLKODUNK, ADUNK HOZZÁ IHLETET! -10%-40%

Akár disztribútori áron!

A BIONIKA CORTILOG PCL Rendszer Felépítményei

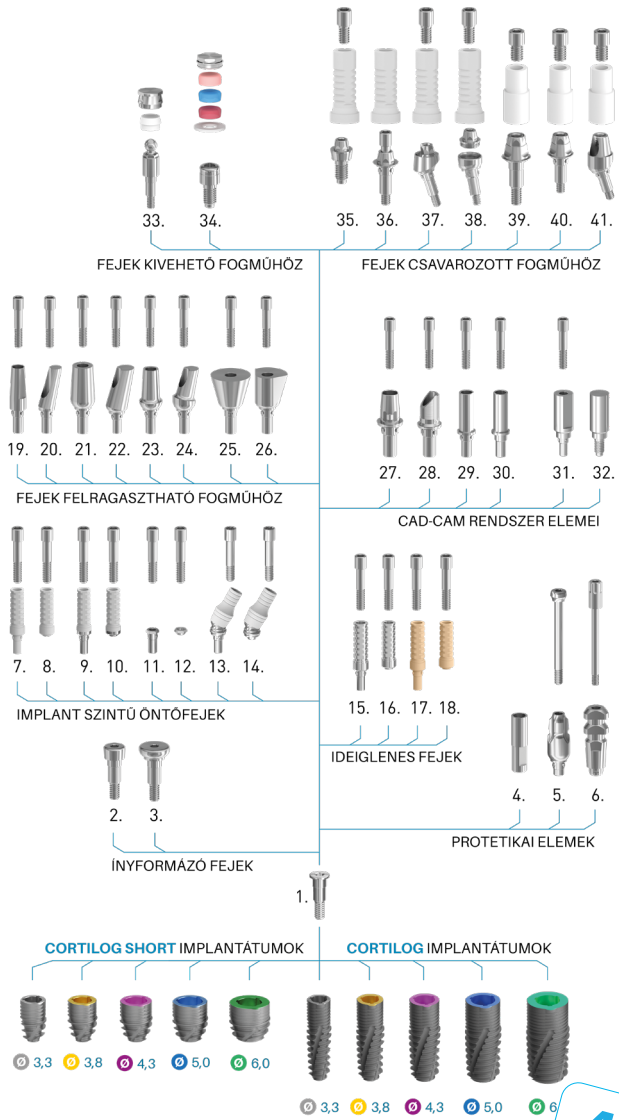


A BIONIKA CORTILOG CCL Rendszer Felépítményei

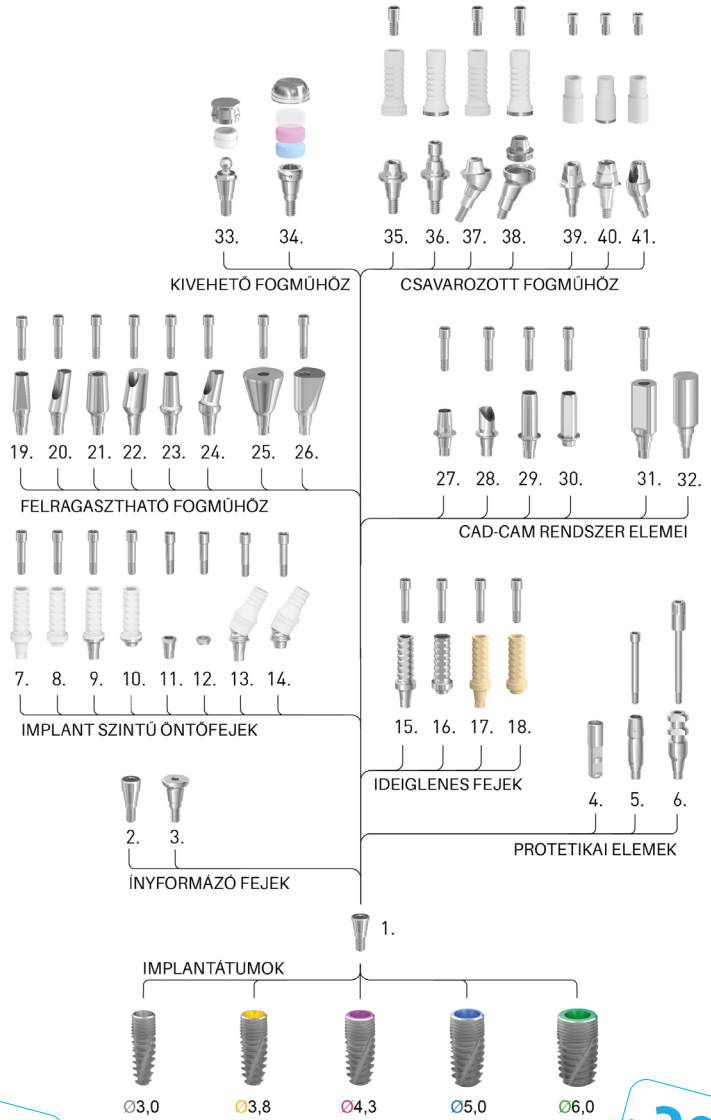


CAMLOG® kompatibilitás: 100% kapcsolat

-40%

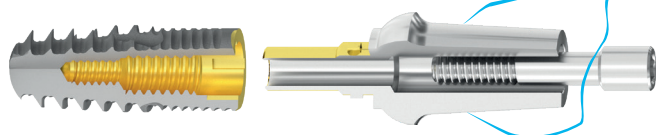

CONELOG® kompatibilitás: 100% kapcsolat

-20%

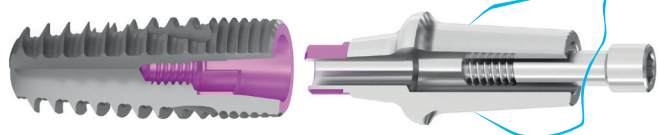

*Az árkedvezmény csak a CORTILOG Rendszer Felépítményeire vonatkozik.

Vevőszolgálat: +36 70 555 3231 • Szakmai tanácsadás: + 36 70 670 6875

BIONIKA Medline Kft. • 3516 Miskolc, Tégla u. 29. • info@bionika.hu

www.bionika.hu • **www.shop.bionika.hu**